DENTAL WORLD

FILL ROOT REMAKE

DAL 2015 11 ANNI DI ESPERIENZA

PROTOCOLLO OPERATIVO

Sigillanti bioceramici premiscelati.

Cementi idraulici *flow* a base di alluminosilicato di calcio.

PROTOCOLLO OPERATIVO

OTTIMA FLUIDITÀ

TECNICA A FREDDO

MASSIMA FLUIDITÀ

TECNICA A CALDO

il Bioce

PACKAGING - FILL ROOT ST codice articolo: **0000182**

- 1 Siringa Fill Root ST 2 g.
- 15 puntali
- Istruzioni
- **Prezzo listino: € 140,00 + IVA**

PACKAGING - REMAKE ROOT HT codice articolo: **0003182**

- 1 Siringa Remake Root HT 2 g.
- 15 puntali
- Istruzioni
- **Prezzo listino: € 168,00 + IVA**

1 PREPARAZIONE DEL CANALE

Terminare le procedure di irrigazione e asciugare il canale con un cono di carta.

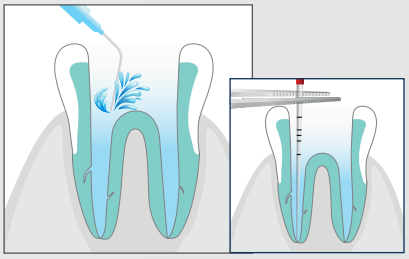



2 SELEZIONARE CONO MASTER

Selezionare e dimensionare il cono master utilizzando un diametro o una conicità precedente all'ultimo strumento di sagomatura.

3 CONNESSIONE PUNTALE E PROVA DI ESTRUSIONE

Collegare il puntale alla siringa e assicurarsi che il prodotto venga estruso correttamente.



4 ESTRUSIONE DEL PRODOT

Opzione 1

Inserire il puntale nel canale al terzo medio, ed estrudere il prodotto.

Estru
su di
inting
con

Caratteristiche e Benefici

- Generazione di idrossido di calcio
- Sigillatura aderente tridimensionale
- Generazione di idrossiapatite
- Legame chimico alla gutta-percha e alla dentina
- Setting time: lavoro (25 min.)
- Setting time: totale (2,5 ore)
- Nessuna contrazione
- Attivazione in campo umido
- Resistenza 100 MPa

Indicazioni Cliniche

- Canali lunghi
- Canali curvi
- Anatomie complesse
- Ritrattamenti
- Canali radicolari laterali

Antibatterico

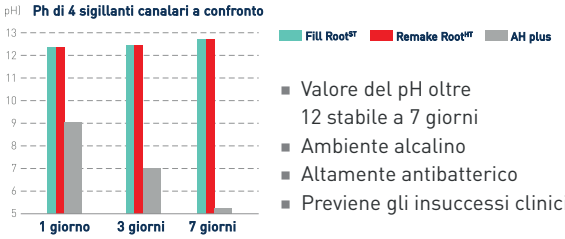

- Valore del pH oltre 12 stabile a 7 giorni
- Ambiente alcalino
- Altamente antibatterico
- Previene gli insuccessi clinici

Biocompatibile

- Alluminosilicato di calcio ad alto grado di incontaminazione
- Privo di resina
- Privo di eugenolo

Facile da utilizzare

- Pronto all'uso
- Pasta premiscelata iniettabile monocomponente
- Compatibile con Thermafil

Radiopacità



Fill Root ST e Remake Root HT utilizzano ossido di zirconio come agente radiopacizzante con i più alti valori di mercato senza discolorare l'elemento.

eramico puro

0%

TRISILICATI

TECNICA 1

COLD TECHNIQUE SINGLE CONE

5st

PREPARAZIONE DEL CANALE

Inserire il cono master nel canale radicolare utilizzando un movimento di "pumping".



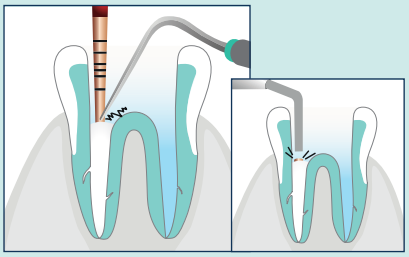

FINITURA

Tagliare il cono master a livello dell'orifizio e condensarlo con un plugger.

6st

Opzione 2

dere il prodotto una piastrina, ere la punta del o ed inserirlo nel canale.

TTO

TECNICA 2

MILD WARM COMPACTION

5mwc

INSERIRE IL CONO MASTER

Inserire il cono master nel canale radicolare utilizzando un movimento di "pumping".





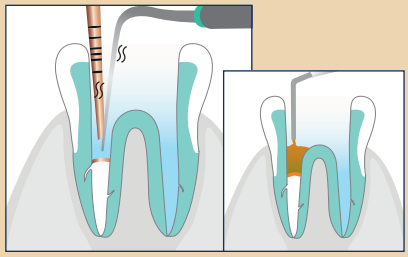

Fase 1

Inserire un portatore di calore fermandosi a 7/8 mm dall'apice, spegnere il compattatore e spingere verso il basso.

Fase 2 / Fase 3

Riaccendere il portatore di calore, tagliando e portando verso l'alto la porzione di cono in eccesso. A questo punto è possibile iniettare della gutta percha calda e condensarla ulteriormente nella porzione coronale del canale.

MILD WARM COMPACTION

6mwc



Adesione chimica garantita grazie all'idrossiapatite.

Immagine al microscopio del test sulle microinfiltrazioni (test di penetrazione); nessuna infiltrazione rilevata.

TECNICA 3

HOT TECHNIQUE CONTINOUS WAVE

5ht

EFFETTUARE IL DOWN PACKING

Portare il cono master a lunghezza di lavoro e condensare a 4/5mm dall'apice.

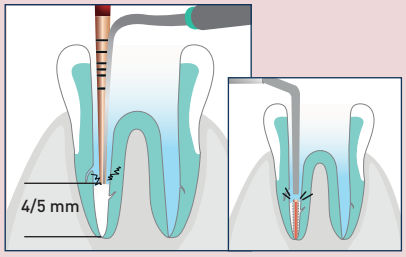

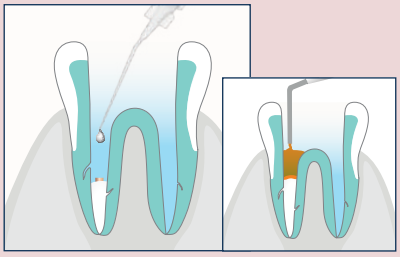

EFFETTUARE IL BACK PACKING

Aggiungere una piccola quantità di cemento fino a 1mm dall'orifizio canalare e compattare con gutta percha liquida.

6ht

RESTA AGGIORNATO

DENTAL WORLD

Dental World s.r.l. Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17
www.dental-world.it / info@dental-world.it

REV.3_02/2026